

E.I.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001078

del 20 DIC. 2019

OGGETTO : Autorizzazione all' espletamento, ai sensi dell'art. 63 c. 2, lett. b del D.Lgs 50/16 , della procedura negoziata MEPA per la fornitura triennale di materiale dedicato alle apparecchiature Burke e Burke in dotazione all'U.O.C. Neonatologia del P.O. Civico

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
<p align="center">U.O.C. PROVVEDITORATO</p> <p>Proposta n. <u>177</u> del <u>10-12-19</u></p> <p>IL Responsabile del procedimento Dott. Santo Pandolfo</p> <p>IL Direttore FF. U.O.C. Provveditorato Ing. Vincenzo Spera</p>	<p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (euro) _____</p> <p>Conto presente atto (Euro)</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa R. Di fresco _____</p>

L'anno duemiladiciannove giorno venti del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n. 195/Serv. 1°/S.G. del 04.04.2019, assistito da Dott. me P.V. Telle, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

19 DIC 2019

Il Direttore FF. *Provveditorato Ing. Vincenzo Spera*

Premesso che:

-con nota prot. 74/19 del 03/09/19 il Direttore dell'U.O. Neonatologia – TIN Dott. Vitaliti l'acquisto di materiale dedicato alle apparecchiature Burke e Burke (**ALL. A**);

Dato atto che in data 11/09/19 si è provveduto a pubblicare sul sito Aziendale indagine di mercato al fine di verificare se gli operatori economici potevano partecipare alla indicenda procedura, nonché per determinare la base di gara (**All. B**);

Dato atto che alla suddetta indagine di mercato ha manifestato interesse la Ditta Dea Medical, esclusivista per la Sicilia Occidentale della Ditta Burke e Burke, indicato come costo orientativo l'importo complessivo di €. 70.000,00, iva esclusa, per la fornitura annuale (**All. C**);

Dare atto che questa Arnas in data 14/11/19, ha pubblicato sul sito europeo SIMAP e su quello aziendale avviso volontario per la trasparenza preventiva (aviso ex ante), relativo alla fornitura in oggetto, con l'obiettivo di verificare se vi fossero altri operatori economici, oltre la Dea Medical, in grado di proporre beni con caratteristiche similari o analoghe; (**ALL. D**);

Che a tale avviso ha dato tempestivo riscontro soltanto la Ditta Dea Medical, la quale ha prodotto dichiarazione di esclusiva e confronto prezzi su tutto il territorio nazionale, confermando il prezzo proposto in sede di indagine di mercato (**All. E**);

Atteso che la vigente normativa (art. 7, comma 2 legge 94/2012, art. 15, comma 13, lettera d della legge 135/2012) obbliga le pubbliche amministrazioni, per acquisti sotto la soglia comunitaria, a utilizzare strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA);

Considerato che si tratta di beni da acquistare ripetutamente tenuto conto che l'U.O, richiedente le utilizza per lo svolgimento dell'attività sanitaria;

Vista la nota prot. 121/19 del 05/12/19 a firma del Direttore dell'U.O.C. di Neonatologia Dott. Vitaliti con la quale chiede, al fine di una continuità di utilizzo del materiale di cui in oggetto, che la fornitura di che trattasi abbia una durata temporale triennale (**All. F**);

Ritenuto che ricorrono i presupposti per procedere ad un acquisto in economia mediante procedura negoziata, utilizzando il MEPA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgvo n. 50/2016, atteso che si tratta peraltro, di importo sotto soglia, indicando quale base di gara triennale l'importo presunto complessivo di € 210.000,00 Iva esclusa, calcolato sul prezzo più basso proposto a seguito di indagine di mercato;

Ritenuto altresì, di conferire esecuzione immediata al presente atto, attesa la necessità e l'urgenza manifestata dal Responsabile dell'U.O. di riferimento, poiché il suddetto materiale è indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature salva vita "ipotermia, ventilatori";

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

PROPONE DI

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati:

Dare atto che, al fine di acquisire materiale dedicato alle apparecchiature Burke e Burke in dotazione all'U.O.C. Neonatologia – TIN dell'Arnas, è stato pubblicato in data 14/11/19 ha pubblicato sul sito europeo SIMAP e su quello aziendale avviso volontario per la trasparenza preventiva (aviso ex ante), relativo alla fornitura in oggetto, con l'obiettivo di verificare se vi fossero altri operatori economici, oltre la Dea Medical, in grado di proporre beni con caratteristiche similari o analoghe;

Dare Atto che a tale avviso ha dato tempestivo riscontro soltanto la Ditta Dea Medical, la quale ha prodotto dichiarazione di esclusiva e confronto prezzi su tutto il territorio nazionale, confermando il prezzo proposto in sede di indagine di mercato;

Dare Atto che, alla luce degli esiti di detta consultazione, l'unico operatore economico che può fornire i beni in argomento è la Dea Medical ;

Autorizzare, in ragione dell'entità della spesa, la procedura ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgvo n. 50/2016, da condurre sul MEPA per la fornitura triennale materiale dedicato alle apparecchiature Burke e Burke per l'U.O.C. Neonatologia del P.O. Civico, individuando l'importo complessivo di € 210.000,00 Iva esclusa, quale base di gara triennale;

Prendere Atto che la somma necessaria a garantire la copertura finanziaria alla presente procedura in economia sarà imputata con successivo provvedimento di aggiudicazione e graverà sui relativi bilanci di competenza;

Dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli nn. 102 comma 6 e 113 del D.Lgs. 50/16, il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche secondo il regolamento che dovrà essere adottato ai sensi dell' art. 113 comma 3 del D.Lgs.50/16, dando atto che il prospetto incentivi è il seguente:

**SCHEMA A - IMPORTO DI GARA A BASE D'ASTA
QUADRO ECONOMICO**

a) BASE D'ASTA COMPLESSIVA

€ 210.000

a1) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso

a2 oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

A3 totale fornitura a base d'asta

a5

) **totale importo appalto**

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

€ 210.000,00
€ 210.00,00

b1 accantonamento di cui all'art.113 D.Lgs. 50/16

b2 spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b3 IVA totale 22%

€ 4.200,00

€ 46.200

parziale

€. 260.400,00

totale costo gara

Curerà l'esecuzione del presente provvedimento l'Area Provveditorato, mentre verrà inviato per conoscenza al Servizio di FARMACIA.

Dare Atto che il RUP della presente procedura è Dott. Santo Pandolfo, il DEC il Direttore dell'U.O. Farmacia o un suo delegato

Dichiarare l' allegato "A -B-C-D-E-F" parte integrante del presente provvedimento.

Conferire al presente atto immediata esecutività, attesa la necessità e l'urgenza manifestata dal Responsabile dell'U.O. di riferimento poiché il suddetto materiale è indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature salva vita" ipotermia, ventilatori";

Il Direttore FF. U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera



PROPONE di
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

19 dic 2019
parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

Sul presente atto viene espresso
parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paola Vitali

Prot 2356 562 03/11/19

AM. Pandolfo
Sopra Copliando
on/for/ea



U.O.C.
NEONATOLOGIA – T.I.N. - NIDO

Direttore: dott. S. M. Vitaliti

in All 14 "

Palermo li, 03/9/2019

Prot. 741/2019

Area Proveditoria

Dirigenti Medici

- P. Ajovalasit
- G. Amella
- G. Attardo
- A. Ciofalo
- F. Composto
- G. Costantino
- L. Li Puma
- D. Mancuso
- M.R. Maresi
- E. Mascellino
- S. Napoli
- L. Nigrelli
- M.P. Re
- C. Scaccianoce
- E. Tranchina

Coord. Infermier.

M.C. Sannino

Oggetto: Fabbisogno annuo materiale dedicato alle apparecchiature Burke&Burke in dotazione ed in uso presso la seguente U.O.C. di Neonatologia.

Con la presente, siamo a richiedere l' acquisto del seguente materiale Burke&Burke Si precisa che tale materiale risulta assolutamente necessario ed indispensabile al corretto funzionamento delle apparecchiature in oggetto:

Materiale per Sistema Raffreddamento Tecotherm:


Nr.5 Cf.	Copertine per materassino, monouso	(Cf. 10 Pz.)	IHTC-FFL
Nr.2 Cf.	Materassino avvolgente Aqua Wrap	(Cf. 10 Pz.)	IHTC-MATT-NEO
Nr.2 Pz.	Cavo adattatore Sensore temperatura rettale		IHTC-FMT400/AEC-P
Nr.2 Pz.	Sensore temperatura rettale, Riutilizzabile		IHTC-FMT400/POR
Nr.2 Pz.	Sensore temperatura cutanea, Riutilizzabile		IHTC-FMT400/AS-THT

Nr.2 Cf.	Sensore temperatura Rettale, Monopaziente	(Cf. 10 Pz.)	IHTC-FMT400/AOR-D/1
Nr.2 Cf.	Elettrodi in Hydrogel per OBM	(Cf. 60 Pz.)	NAOBM00042
Nr.4 Cf.	Elettrodi ad Ago per OBM	(Cf. 24 Pz.)	NAOBM00046
Nr.1 Cf.	Pastiglie di diossido di cloro	(Cf. 30 Pz.)	IHTC-CDT
Nr.10 Cf.	Sensore SenSmart Equanox Neo	(Cf. 20 Pz.)	NN9750-001

Materiale per CPAP

Pz.40	Hydrocolloide Septal H <500g	(Cf. 20 Pz.)	WMCP-5400A
Pz.40	Hydrocolloide Septal H 500g e 1,2 Kg	(Cf. 20 Pz.)	WMCP-5410A
Pz.40	Hydrocolloide Septal H 1,2Kg e 2,5 Kg	(Cf. 20 Pz.)	WMCP-5500A
Pz.40	Hydrocolloide Septal H > 2,5 Kg	(Cf. 20 Pz.)	WMCP-5510A
Pz.40	Cerotti guanciali in Hydrocolloide Mis. S	(Cf. 20 Pz.)	MJ1380
Pz.40	Cerotti guanciali in Hydrocolloide Mis. M	(Cf. 20 Pz.)	MJ1381
Pz.40	Tortle Midliner Diam 17-22 cm	(Cf. 10 Pz.)	TT65911-FP
Pz.30	Tortle Midliner Diam 22-30 cm	(Cf. 10 Pz.)	TT65901-FP
Pz.30	Tortle Midliner Diam 30-38 cm	(Cf. 10 Pz.)	TT65903-FP
Pz.20	NeoSmart XS <750g	(Cf. 10 Pz.)	BBNS-CS000
Pz.30	NeoSmart S 750g e 1,5 Kg	(Cf. 10 Pz.)	BBNS-CS001
Pz.30	NeoSmart M 1,5kg e 2,5 Kg	(Cf. 10 Pz.)	BBNS-CS002
Pz.30	NeoSmart L > 2,5 Kg	(Cf. 10 Pz.)	BBNS-CS003
Pz.70	Circuito per T-Piece	(Cf. 10 Pz.)	10-50900
Pz.70	Circuito Neo-Tee per Rianimazione	(Cf. 10 Pz.)	MF10-50822
Pz.16	Cavo sonde temperatura Hydraltis	(Cf. 1 Pz.)	BBHY9500-100NS
Pz.16	Cavo riscaldamento doppio Hydraltis	(Cf. 1 Pz.)	BBHY9500-102NS

Il Direttore dell'U.O.C.
Marcello Vitaliti

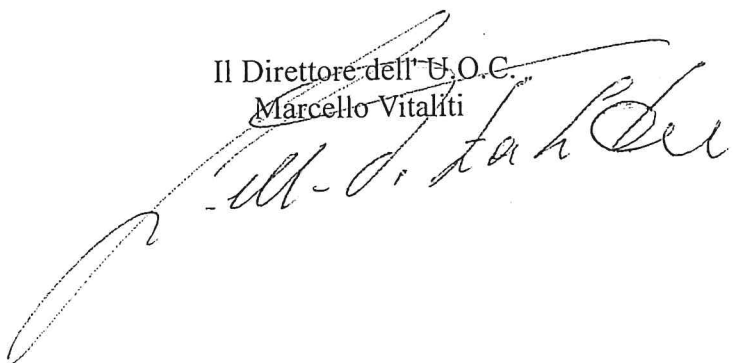



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Provveditorato
Piazza Nicola Leotta n. 4
Telefono: 091- 6662261/636
Fax: 091 – 6662301
www.arnascivico.it
E-mail: provveditorato @arnascivico.it
P.IVA 058417708283

Palermo li, 11-09-19
Prot. 2461

DITTE VARIE

Oggetto: Indagine di mercato per "La fornitura annuale di materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm e materiale per CPAP in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico"

Questa Amministrazione deve acquistare materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm e materiale per CPAP in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone del suddetto materiale;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Nel caso che, al presente avviso darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il 20.09.2019 al seguente indirizzo email: provveditorato@arnascivico.it, per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 091/6662636.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare allo scrivente ufficio se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il Direttore FF. Area Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera

Prot 2585 del 23/09/19 *grafico conto capitale*
23/09/2019



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Indagine di mercato materiale per Tecotherm e CPAP per UOC Neonatologia UTIN PO Civico -ARNAS di PA- scad. 20-09-2019 - Vs Prot 2461 del 11/09/2019

1 messaggio

amministrazione <amministrazione@deamedical.com>
A: provveditorato@arnascivico.it

20 settembre 2019 17:31

Buongiorno,

In riferimento alla Vs. Prot. N. 2461 del 11/09/2019 , in allegato trasmetto quanto richiesto

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti

Grazie

Claudio De Angelis
Amministratore

Dea Medical srl
via De Amicis n°28
90143 Palermo - Italy
PH/Fax +39091306288
amministrazione@deamedical.com

*NON SONO INDICATE LE
AZ. SSN O PRIVATE ALLE
QUALI SONO PRAZICATI
I PREZZI RIPORTATI NELLA
ALLEGATA TABELLA !!*

Dichiarazione di Riservatezza

Le informazioni contenute in questo messaggio (inclusi eventuali allegati), sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di procedere alla sua distruzione; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

Statement of Confidentiality

The information contained in this message (including any attachments) are confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error please notify the sender immediately and destroy any copy which may be in your possession. Dissemination, distribution or reproduction by anyone is prohibited by Italian Legislative Decree no. 196/2003.

Indagine di Mercato Vs Prot 2461.pdf
2245K

1/1 All e 4

Dea  MEDICAL
HEALTH CARE SOLUTION

Palermo, 19/09/2019

Spett.le
A.R.N.A.S
U.O.C. Provveditorato
P.zza N. Leotta, n. 4
90127 Palermo (PA)

Oggetto: Indagine di Mercato per "La fornitura annuale di materile dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm e materiale per CPAP in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico"- Vs. Prot. N. 2461 del 11/09/2019

Il Sottoscritto Claudio De Angelis, nato a Palermo il 07/07/1988, e residente a Palermo (PA), in Via Ferdinando Palasciano n. 22, CF: DNGCLD88L07G273N, in qualità di Legale rappresentante della ditta Dea Medical Srl con sede in Palermo, Via Edmondo De Amicis, n. 28 con P. I.V.A. n°. 06571670825, Tel/Fax 091/306288 e indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio gare- amministrazione@deamedical.com


DICHIARA

In riferimento all'indagine di mercato in oggetto, con la presente Vi confermiamo di avere prodotti con caratteristiche collimanti a quelle richieste (Vedi scheda tecnica allegata).

Vi informiamo inoltre che siamo presenti sul MEPA.

RingraziandoVi, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. distinti saluti.

DEA MEDICAL Srl



(Claudio De Angelis)

SCHEDA TECNICA

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO
MATERIALE PER SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO TECOTHERM			
1	Copertine per materassino monouso (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Copertine di rivestimento usa e getta dotate di un sottile strato plastificato impermeabile, sul lato inferiore, in maniera tale da proteggere la stuoia dal sangue, dall'umore acqueo o da altri liquidi. Contemporaneamente proteggono il neonato e il lattante dal contatto (bagnatura) con il fluido di riempimento del materassino (in caso di perdita)
2	Materassino avvolgente Aqua Wrap, riutilizzabile	SI - Caratteristiche Collimanti	Materassino avvolgente di raffreddamento in cui viene fatto circolare il liquido refrigerante per creare ipotermia nel neonato. Riutilizzabile e da utilizzarsi esclusivamente con il sistema per il trattamento ipotermico TecothermNeo.
3	Cavo adattatore per sensore rettale	SI - Caratteristiche Collimanti	Cavo adattatore per sensore rettale riutilizzabile e collega il sensore temperatura rettale con il sistema per ipotermia sistemica
4	Sensore temperatura rettale riutilizzabile	SI - Caratteristiche Collimanti	Sensore di temperatura riutilizzabile della serie FMT 400 per la misura in continua e il monitoraggio della temperatura rettale di pazienti neonatali
5	Sensore di temperatura cutanea, riutilizzabile	SI - Caratteristiche Collimanti	Sensore di temperatura riutilizzabile della serie FMT 400 per la misura in continua e il monitoraggio della temperatura cutanea di pazienti neonatali

Dea MEDICAL

HEALTH CARE SOLUTION

6	Sensore di temperatura rettale/esofagea mono (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Sensore di temperatura rettale/esofagea monopaziente
7	Elettrodi di Hydrogel per OBM (Cf 60 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Elettrodi in Hidrogel a bassa impedenza per EEG, per applicazione cutanea. Il connettore dell'elettrodo è di tipo touch-proof
8	Elettrodi ad ago per OBM (Cf 24 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Elettrodi ad ago a bassa impedenza per la rilevazione sottocutanea dei segnali biologici per esame EEG. Il connettore dell'elettrodo è di tipo touch-proof
9	Pastiglie ClO2 (Cf 30 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le Pastiglie ClO2 sono la forma più sicura e più efficace di disinfezione chimica dell'acqua
10	Sensore SenSmart™ EQUANOX™ rSO2 Advance neo/ped (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Il sensore per ossimetria regionale pediatrico/neonatale non adesivo Advance mod. 8004CB-NA funziona in base al principio della spettroscopia nel vicino infra-rosso

MATERIALE PER CPAP


1	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Prematuri ≤ 500g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Prematuri ≤ 500g
2	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Neonati 500g < >1200g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione protezione Mis Neonati 500g < >1200g
3	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Infanti 1200g < >2500g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione protezione Mis Infanti 1200g < >2500g
4	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Pediatriche ≥ 2500g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione protezione Mis Pediatriche ≥ 2500g
5	Cerotti di fissaggio Mis S (Cf 10 Pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Cerotti di fissaggio di forma anatomica a base idrocolloide progettati per creare condizioni ottimali per la pelle, evitando lacerazioni cutanee.
6	Cerotti di fissaggio Mis L (Cf 10 Pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Cerotti di fissaggio di forma anatomica a base idrocolloide progettati per creare condizioni ottimali per la pelle, evitando lacerazioni cutanee.
7	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - oro (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Tortle Midliner ELBW: diametro 17-22 cm
8	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde scuro (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Tortle Midliner Micro-Preemie: diametro 22-30 cm

Dea MEDICAL

HEALTH CARE SOLUTION

9	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde chiaro (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Tortle Midliner Preemie: diametro 30-38 cm
10	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia XS (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia XS per micro-prematuri con peso corporeo < 750g
11	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia S (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia S per prematuri con peso corporeo compreso tra 750g e 1.500g
12	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia M (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia M per neonati con peso corporeo compreso tra 1.500g e 2.500g
13	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia L (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia L per infanti con peso corporeo > 2.500g
14	Circuito paziente con raccordo a T universale, monouso (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Circuito paziente con raccordo a T universale
15	Neo-Tee™ rianimatore neonatale (0-60 cmH2O) con unità di controllo in linea e "Override" (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Rianimatore neonatale con raccordo a T alimentato a gas per la ventilazione di neonati e bambini con peso inferiore ai 10 kg
16	Cavo sonde di temperatura	SI - Caratteristiche Collimanti	Cavo sonde di Temperatura che rilevano costantemente la temperatura del gas all'interno del circuito respiratorio all'uscita della camera di umidificazione e in prossimità del paziente, a livello della "Y", consentendo il corretto funzionamento dell'umidificatore.
17	Cavo di riscaldamento doppio	SI - Caratteristiche Collimanti	Cavo di riscaldamento doppio per alimentare elettricamente i filari riscaldanti dei circuiti paziente a singolo e doppio riscaldamento

DEA MEDICAL Srl



(Claudio De Angelis)

001078

Cognome: DE ANGELIS
 Nome: GIARDIO
 Data di nascita: 7.7.1988
 Indirizzo: PALERMO
 Città: PALERMO
 Provincia: PALERMO
 Via: PALERMIANO-PERLINANDO N.122
 Stato civile: LIBERO PROFESSIONISTA
 Professione: CONTOVANT E CONTABILISTI SALERI
 Sesso: M
 Altezza: 1.83
 Cognome: CASTANI
 Nome: CASTANI
 Segni particolari: ***

Prima del 1988: PALERMO, 125.2.2016
 Firma: *Deo Angelis*
 Munita di Palermo
 Sindaco: *[Signature]*
 AX 2719321

SCADDE IL 07.07.2026
 AX 2719321

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI PALERMO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AX 2719321
 DI DE ANGELIS GIARDIO

Palermo, 19/09/2019

Spett.le
A.R.N.A.S
U.O.C. Provveditorato
P.zza N. Leotta, n. 4
90127 Palermo (PA)

Oggetto: Indagine di Mercato per "La fornitura annuale di materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm e materiale per CPAP in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico"- Vs. Prot. N. 2461 del 11/09/2019

Il Sottoscritto Claudio De Angelis, nato a Palermo il 07/07/1988, e residente a Palermo (PA), in Via Ferdinando Palasciano n. 22, CF: DNGCLD88L07G273N, in qualità di Legale rappresentante della ditta Dea Medical Srl con sede in Palermo, Via Edmondo De Amicis, n. 28 con P. I.V.A. n°. 06571670825, Tel/Fax 091/306288 e indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio gare- amministrazione@deamedical.com

DICHIARA

- ✓ Sono prodotti originali, trattati in esclusiva, sul territorio nazionale, dalla Burke & Burke SpA;
- ✓ Che la sottoscritta Dea Medical Srl, è rivenditore esclusivista per la regione Sicilia Occidentale;
- ✓ Del seguente materiale, il prezzo di mercato

MATERIALE PER SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO TECOTHERM


Q.tà.	DESCRIZIONE	COD	Prezzo di Mercato € (IVA Esclusa)	Importo di mercato € (IVA Esclusa)
5 Cf	Copertine per materassino monouso (Cf 10 pz)	IHTC-FFL	190,00	950,00
2 Pz	Materassino avvolgente Aqua Wrap, riutilizzabile	IHTC-MATT-NEO	1.000,00	2.000,00
2 Pz	Cavo adattatore per sensore rettale	IHTC-FMT400/AEC-P	50,00	100,00
2 Pz	Sensore temperatura rettale riutilizzabile	IHTC-FMT400/POR	520,00	1.040,00
2 Pz	Sensore di temperatura cutanea, riutilizzabile	IHTC-FMT400/AS-THT	820,00	1.640,00
2 Cf	Sensore di temperatura rettale/esofagea mono (Cf 10 pz)	IHTC-FMT400/AOR-D/10	300,00	600,00
2 Cf	Elettrodi di Hydrogel per OBM (Cf 60 pz)	NAOBM00042	1.100,00	2.200,00
4 Cf	Elettrodi ad ago per OBM (Cf 24 pz)	NAOBM00046	700,00	2.800,00
1 Cf	Pastiglie ClO2 (Cf 30 pz)	IHTC-CDT	60,00	60,00
10 Cf	Sensore SenSmart™ EQUANOX™ rSO2 Advance neo/ped (Cf 20 pz)	NN9750-001	3.200,00	32.000,00


Dea MEDICAL

HEALTH CARE SOLUTION

MATERIALE PER CPAP				
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Prematuri < 500g (Cf 20 pz)	WMCP-5400A	280,00	560,00
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Neonati 500g < >1200g (Cf 20 pz)	WMCP-5410A	280,00	560,00
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Infanti 1200g < >2500g (Cf 20 pz)	WMCP-5500A	280,00	560,00
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Pediatriche ≥ 2500g (Cf 20 pz)	WMCP-5510A	310,00	620,00
4 Cf	Cerotti di fissaggio Mis S (Cf 10 Pz)	MJ1380	130,00	520,00
4 Cf	Cerotti di fissaggio Mis L (Cf 10 Pz)	MJ1381	150,00	600,00
4 Cf	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - oro (Cf 10 pz)	TT65911-FP	190,00	760,00
3 Cf	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde scuro (Cf 10 pz)	TT65901-FP	190,00	570,00
3 Cf	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde chiaro (Cf 10 pz)	TT65903-FP	190,00	570,00
2 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia XS (Cf 10 pz)	BBNS-CS000	510,00	1.020,00
3 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia S (Cf 10 pz)	BBNS-CS001	510,00	1.530,00
3 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia M (Cf 10 pz)	BBNS-CS002	510,00	1.530,00
3 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia L (Cf 10 pz)	BBNS-CS003	510,00	1.530,00
7 Cf	Circuito paziente con raccordo a T universale, monouso (Cf 10 pz)	MF10-50900	130,00	910,00
7 Cf	Neo-Tee™ rianimatore neonatale (0-60 cmH2O) con unità di controllo in linea e "Override (Cf 10 pz)	MF10-50822	350,00	2.450,00
16 Pz	Cavo sonde di temperatura	BBHY9500-100NS	470,00	7.520,00
16 Pz	Cavo di riscaldamento doppio	BBHY9500-102NS	300,00	4.800,00

DEA MEDICAL Srl


 (Claudio De Angelis)

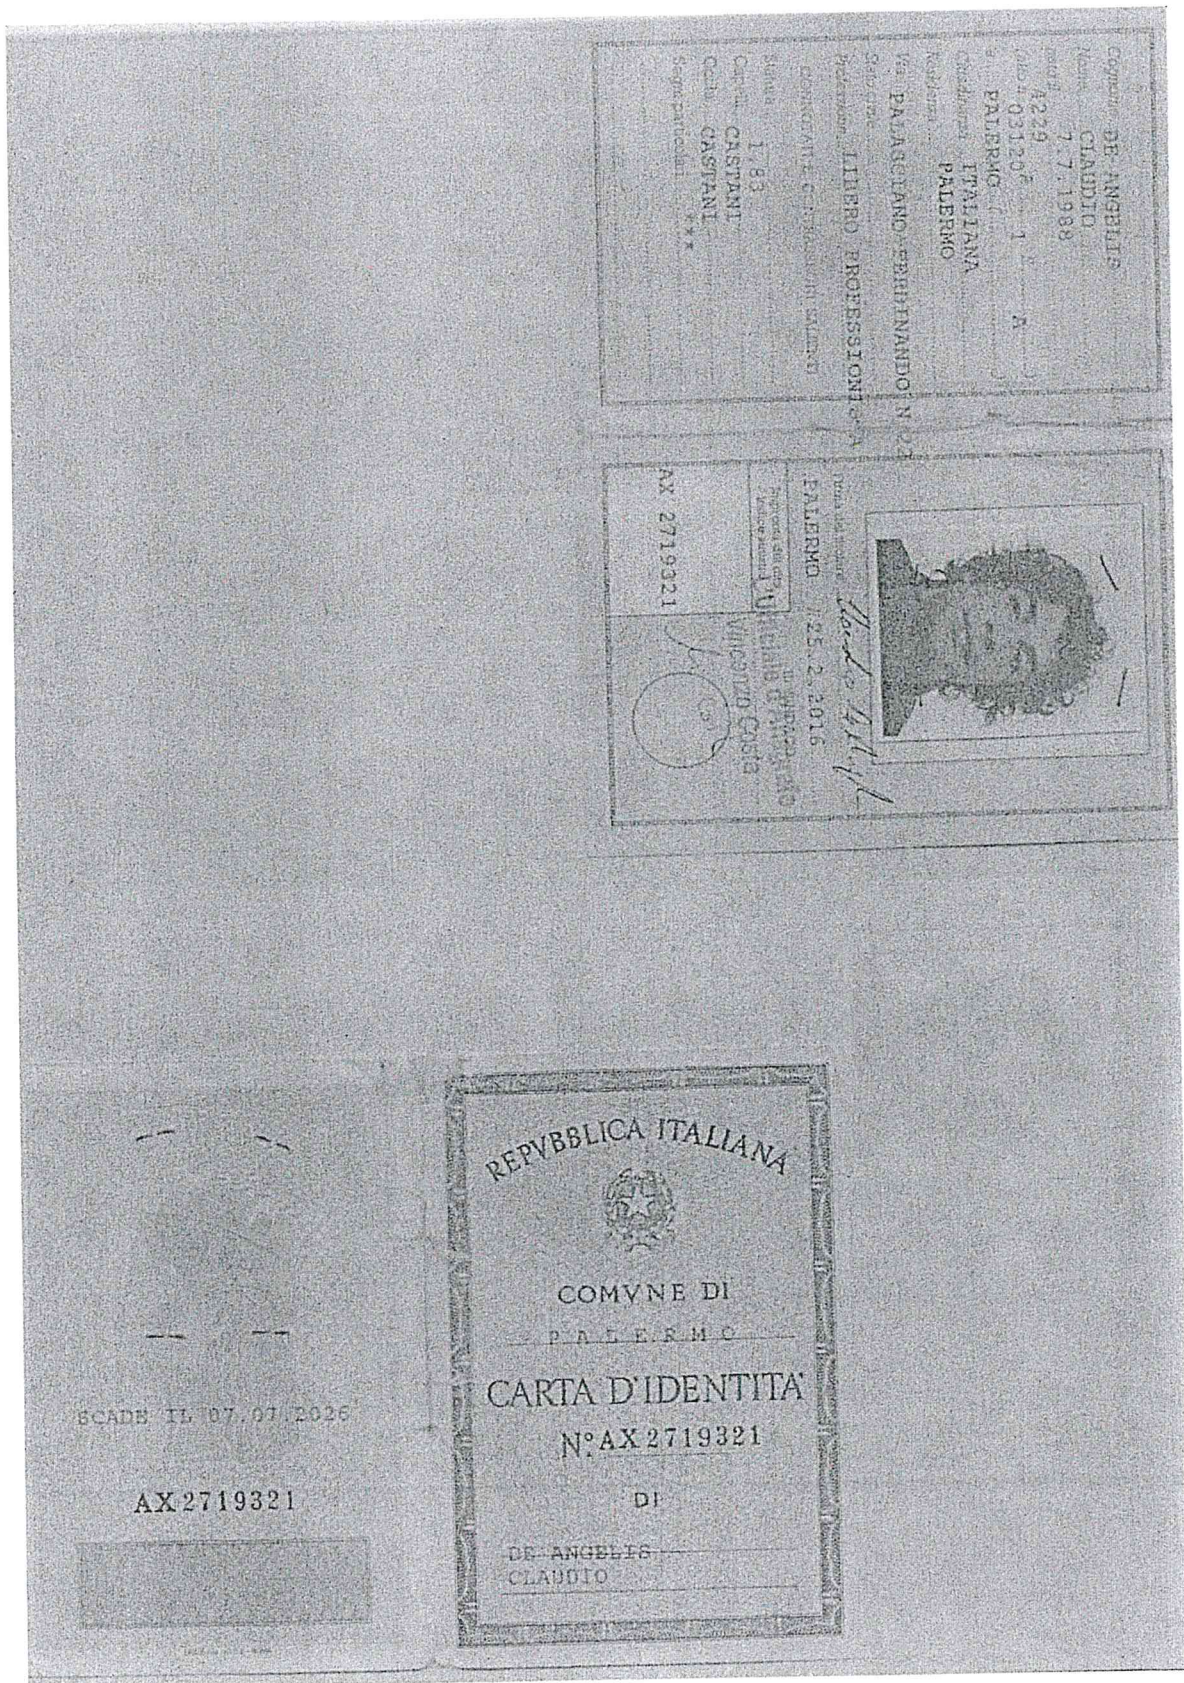

Palermo, 19/09/2019

Spett.le
A.R.N.A.S
U.O.C. Provveditorato
P.zza N. Leotta, n. 4
90127 Palermo (PA)

Oggetto: Indagine di Mercato per "La fornitura annuale di materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm e materiale per CPAP in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico"- Vs. Prot. N. 2461 del 11/09/2019

ELENCO PREZZI PRATICATI NEGLI ULTIMI 12 MESI


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000

Il Sottoscritto Claudio De Angelis, nato a Palermo il 07/07/1988, e residente a Palermo (PA), in Via Ferdinando Palasciano n. 22, CF: DNGCLD88L07G273N, in qualità di Legale rappresentante della ditta Dea Medical Srl con sede in Palermo, Via Edmondo De Amicis, n. 28 con P. I.V.A. n°. 06571670825, Tel/Fax 091/306288 e indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio gare- amministrazione@deamedical.com


DICHIARA

- ✓ Di non poter presentare il miglior prezzo di aggiudicazione per forniture analoghe degli ultimi 24 MESI, in quanto il mandato di agente/rivenditore Esclusivista Burke & Burke SpA, per la SICILIA OCCIDENTALE è del gennaio 2019, e pertanto allega dichiarazione di casa madre .


DEA MEDICAL Srl



(Claudio De Angelis)

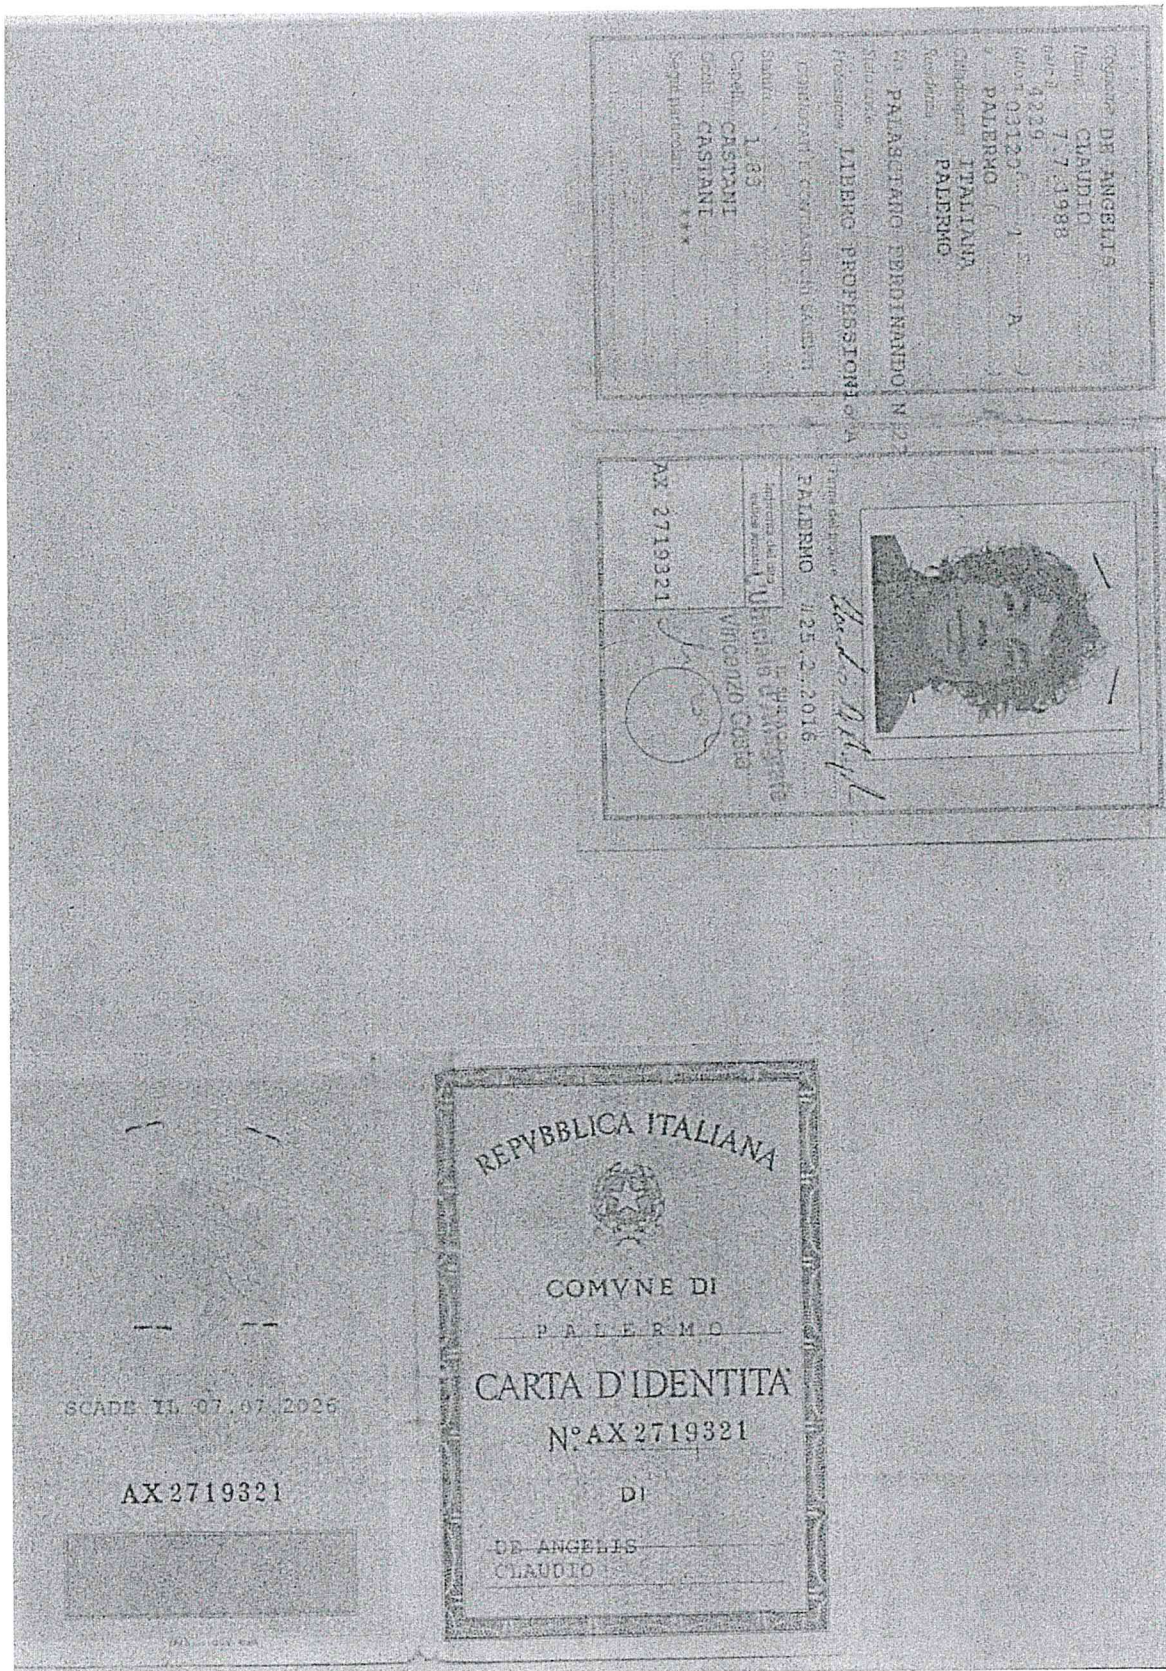

Questo sito Novità | Informazioni su eNotices | Domande e risposte | Guida | Per contattarci | Avviso Legale



Ted-eNotices

Formulari per gli appalti pubblici

italiano (it)

Handwritten: "All" with an arrow pointing right.

EUROPA > eNotices.> Formulari on line

- TED**
- TED SIMAP**
- TED eNotices
- TED eTendering

Nome: SANTO
 Cognome: PANDOLFO
 Nome utente:
 ECAS_n002tyi7

Informazioni sull'avviso

[<<Tornare agli avvisi](#)

Menu utente
Nuovo formulario
I vostri bandi
Profilo utente
Log out

Avviso volontario per la trasparenza ex ante - materiale dedicato al sistema di raffreddamento Tecotherm in uso presso la Neonatologia Utin **IT**

Creato : 14/11/2019 11:48 Presentato : 14/11/2019 11:48
 Stato : Presentato (Il bando è stato presentato per la pubblicazione)
 Titolo ufficiale : IT-palermo: Apparecchiature mediche

Appalti in tale avviso:

0. materiale dedicato al sistema di raffreddamento Tecotherm in uso presso la Neonatologia Utin

[Tornare agli avvisi](#) [Archiviare](#)

Per contattarci | Avviso Legale | Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni | [Inizio pagina](#)

Handwritten: "Scadenza 25/11/19" with a signature below it.



Civico Di Cristina Benfratelli
Asociación de Servicios Benéficos del Área Sanitaria

Prot 3551 del 27-11-19 (Raffiorato) conto Cass-Toll
NO 27/11/2019
Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Oggetto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante per "La fornitura annuale di materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico"- Vs. Rif. N. 2019/S 223-548293

1 messaggio

amministrazione <amministrazione@deamedical.com>
A: provveditorato@arnascivico.it

25 novembre 2019 19:27

In riferimento alla Vs. N. 2019/S 223-548293 , in allegato trasmetto quanto richiesto
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo
Distinti saluti

"All F"

Claudio De Angelis
Amministratore

Dea Medical srl
via De Amicis n°28
90143 Palermo - Italy
PH/Fax +39091306288
amministrazione@deamedical.com

Dichiarazione di Riservatezza

Le informazioni contenute in questo messaggio (inclusi eventuali allegati), sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di procedere alla sua distruzione; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

Statement of Confidentiality

The information contained in this message (including any attachments) are confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error please notify the sender immediately and destroy any copy which may be in your possession. Dissemination, distribution or reproduction by anyone is prohibited by Italian Legislative Decree no. 196/2003.

Avviso volontario per la trasparenza.pdf
861K

Palermo, 25/11/2019

Spett.le
A.R.N.A.S
U.O.C. Provveditorato
P.zza N. Leotta, n. 4
90127 Palermo (PA)

Oggetto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante per "La fornitura annuale di materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Utin del P.O. Civico"- Vs. Rif. N. 2019/S 223-548293

Il Sottoscritto Claudio De Angelis, nato a Palermo il 07/07/1988, e residente a Palermo (PA), in Via Ferdinando Palasciano n. 22, CF: DNGCLD88L07G273N, in qualità di Legale rappresentante della ditta Dea Medical Srl con sede in Palermo, Via Edmondo De Amicis, n. 28 con P. I.V.A. n°. 06571670825, Tel/Fax 091/306288 e indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio gare- amministrazione@deamedical.com

DICHIARA


In riferimento all'avviso in oggetto, con la presente Vi confermiamo di avere prodotti con caratteristiche collimanti a quelle richieste (Vedi scheda tecnica allegata).

Di essere rivenditore esclusivista per la regione Sicilia Occidentale;

Vi informiamo inoltre che siamo presenti sul MEPA.

RingraziandoVi, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. distinti saluti.

DEA MEDICAL Srl

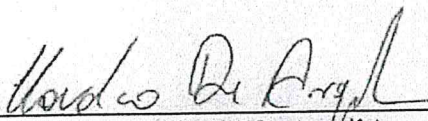

(Claudio De Angelis)

SCHEDA TECNICA

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO
MATERIALE PER SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO TECOTHERM			
1	Copertine per materassino monouso (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Copertine di rivestimento usa e getta dotate di un sottile strato plastificato impermeabile, sul lato inferiore, in maniera tale da proteggere la stuoia dal sangue, dall'umore acqueo o da altri liquidi. Contemporaneamente proteggono il neonato e il lattante dal contatto (bagnatura) con il fluido di riempimento del materassino (in caso di perdita)
2	Materassino avvolgente Aqua Wrap, riutilizzabile	SI - Caratteristiche Collimanti	Materassino avvolgente di raffreddamento in cui viene fatto circolare il liquido refrigerante per creare ipotermia nel neonato. Riutilizzabile e da utilizzarsi esclusivamente con il sistema per il trattamento ipotermico TecothermNeo.
3	Cavo adattatore per sensore rettale	SI - Caratteristiche Collimanti	Cavo adattatore per sensore rettale riutilizzabile e collega il sensore temperatura rettale con il sistema per ipotermia sistemica
4	Sensore temperatura rettale riutilizzabile	SI - Caratteristiche Collimanti	Sensore di temperatura riutilizzabile della serie FMT 400 per la misura in continua e il monitoraggio della temperatura rettale di pazienti neonatali
5	Sensore di temperatura cutanea, riutilizzabile	SI - Caratteristiche Collimanti	Sensore di temperatura riutilizzabile della serie FMT 400 per la misura in continua e il monitoraggio della temperatura cutanea di


			pazienti neonatali
6	Sensore di temperatura rettale/esofagea mono (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Sensore di temperatura rettale/esofagea monopaziente
7	Elettrodi di Hydrogel per OBM (Cf 60 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Elettrodi in Hidrogel a bassa impedenza per EEG, per applicazione cutanea. Il connettore dell'elettrodo è di tipo touch-proof
8	Elettrodi ad ago per OBM (Cf 24 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Elettrodi ad ago a bassa impedenza per la rilevazione sottocutanea dei segnali biologici per esame EEG. Il connettore dell'elettrodo è di tipo touch-proof
9	Pastiglie ClO ₂ (Cf 30 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le Pastiglie ClO ₂ sono la forma più sicura e più efficace di disinfezione chimica dell'acqua
10	Sensore SenSmart™ EQUANOX™ rSO ₂ Advance neo/ped (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Il sensore per ossimetria regionale pediatrico/neonatale non adesivo Advance mod. 8004CB-NA funziona in base al principio della spettroscopia nel vicino infra-rosso
MATERIALE PER CPAP			
1	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Prematuri ≤ 500g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Prematuri ≤ 500g
2	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Neonati 500g < >1200g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione protezione Mis Neonati 500g < >1200g
3	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Infanti 1200g < >2500g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione protezione Mis Infanti 1200g < >2500g
4	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Pediatrici ≥ 2500g (Cf 20 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione protezione Mis Pediatrici ≥ 2500g
5	Cerotti di fissaggio Mis S (Cf 10 Pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Cerotti di fissaggio di forma anatomica a base idrocolloide progettati per creare condizioni ottimali per la pelle, evitando lacerazioni cutanee.
6	Cerotti di fissaggio Mis L (Cf 10 Pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Cerotti di fissaggio di forma anatomica a base idrocolloide progettati per creare condizioni ottimali per la pelle, evitando lacerazioni cutanee.
7	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - oro (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Tortle Midliner ELBW: diametro 17-22 cm

Dea MEDICAL

HEALTH CARE SOLUTION

8	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde scuro (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Tortle Midliner Micro-Preemie: diametro 22-30 cm
9	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde chiaro (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Tortle Midliner Preemie: diametro 30-38 cm
10	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia XS (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia XS per micro-prematuri con peso corporeo < 750g
11	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia S (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia S per prematuri con peso corporeo compreso tra 750g e 1.500g
12	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia M (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia M per neonati con peso corporeo compreso tra 1.500g e 2.500g
13	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia L (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Le nasocannule NeoSmart™ Taglia L per infanti con peso corporeo > 2.500g
14	Circuito paziente con raccordo a T universale, monouso (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Circuito paziente con raccordo a T universale
15	Neo-Tee™ rianimatore neonatale (0-60 cmH2O) con unità di controllo in linea e "Override" (Cf 10 pz)	SI - Caratteristiche Collimanti	Rianimatore neonatale con raccordo a T alimentato a gas per la ventilazione di neonati e bambini con peso inferiore ai 10 kg
16	Cavo sonde di temperatura	SI - Caratteristiche Collimanti	Cavo sonde di Temperatura che rilevano costantemente la temperatura del gas all'interno del circuito respiratorio all'uscita della camera di umidificazione e in prossimità del paziente, a livello della "Y", consentendo il corretto funzionamento dell'umidificatore.
17	Cavo di riscaldamento doppio	SI - Caratteristiche Collimanti	Cavo di riscaldamento doppio per alimentare elettricamente i filì riscaldanti dei circuiti paziente a singolo e doppio riscaldamento

DEA MEDICAL Srl

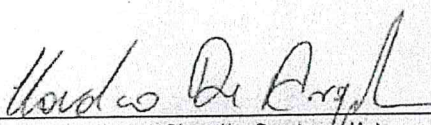
(Claudio De Angelis)

001078

Cognome DE ANGELIS
 Nome CLAUDIO
 Data di nascita 7.7.1989
 Sesso M
 Telefono 091202115
 Città PALERMO
 Indirizzo ITALIA PALERMO
 Residente
 Via PALAZZINO FERDINANDO N.22
 001078
 Professione LIBERO PROFESSIONISTA
 Indirizzo Professione DONNOVATI & CONTABILITA' CALLENTI
 Spese 1.83
 Cognome CASTANI
 Cognome CASTANI
 Segni particolari ***

Firma del titolare *Claudio De Angelis*
 EMERMO 25.2.2016
 Sindaco *Vincenzo Cosia*
 AX 2719321



SCADE IL 07.07.2026

AX 2719321

REPUBBLICA ITALIANA


 COMUNE DI PALERMO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AX 2719321
 DI
 DE ANGELIS CLAUDIO


Dea MEDICAL

HEALTH CARE SOLUTION

MATERIALE PER CPAP				
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Prematuri < 500g (Cf 20 pz)	WMCP-5400A	280,00	560,00
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Neonati 500g < >1200g (Cf 20 pz)	WMCP-5410A	280,00	560,00
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Infanti 1200g < >2500g (Cf 20 pz)	WMCP-5500A	280,00	560,00
2 Cf	Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Pediatriche ≥ 2500g (Cf 20 pz)	WMCP-5510A	310,00	620,00
4 Cf	Cerotti di fissaggio Mis S (Cf 10 Pz)	MJ1380	130,00	520,00
4 Cf	Cerotti di fissaggio Mis L (Cf 10 Pz)	MJ1381	150,00	600,00
4 Cf	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - oro (Cf 10 pz)	TT65911-FP	190,00	760,00
3 Cf	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde scuro (Cf 10 pz)	TT65901-FP	190,00	570,00
3 Cf	Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde chiaro (Cf 10 pz)	TT65903-FP	190,00	570,00
2 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia XS (Cf 10 pz)	BBNS-CS000	510,00	1.020,00
3 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia S (Cf 10 pz)	BBNS-CS001	510,00	1.530,00
3 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia M (Cf 10 pz)	BBNS-CS002	510,00	1.530,00
3 Cf	Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia L (Cf 10 pz)	BBNS-CS003	510,00	1.530,00
7 Cf	Circuito paziente con raccordo a T universale, monouso (Cf 10 pz)	MF10-50900	130,00	910,00
7 Cf	Neo-Tee™ rianimatore neonatale (0-60 cmH2O) con unità di controllo in linea e "Override (Cf 10 pz)	MF10-50822	350,00	2.450,00
16 Pz	Cavo sonde di temperatura	BBHY9500-100NS	470,00	7.520,00
16 Pz	Cavo di riscaldamento doppio	BBHY9500-102NS	300,00	4.800,00

DEA MEDICAL Srl


 (Claudio De Angelis)

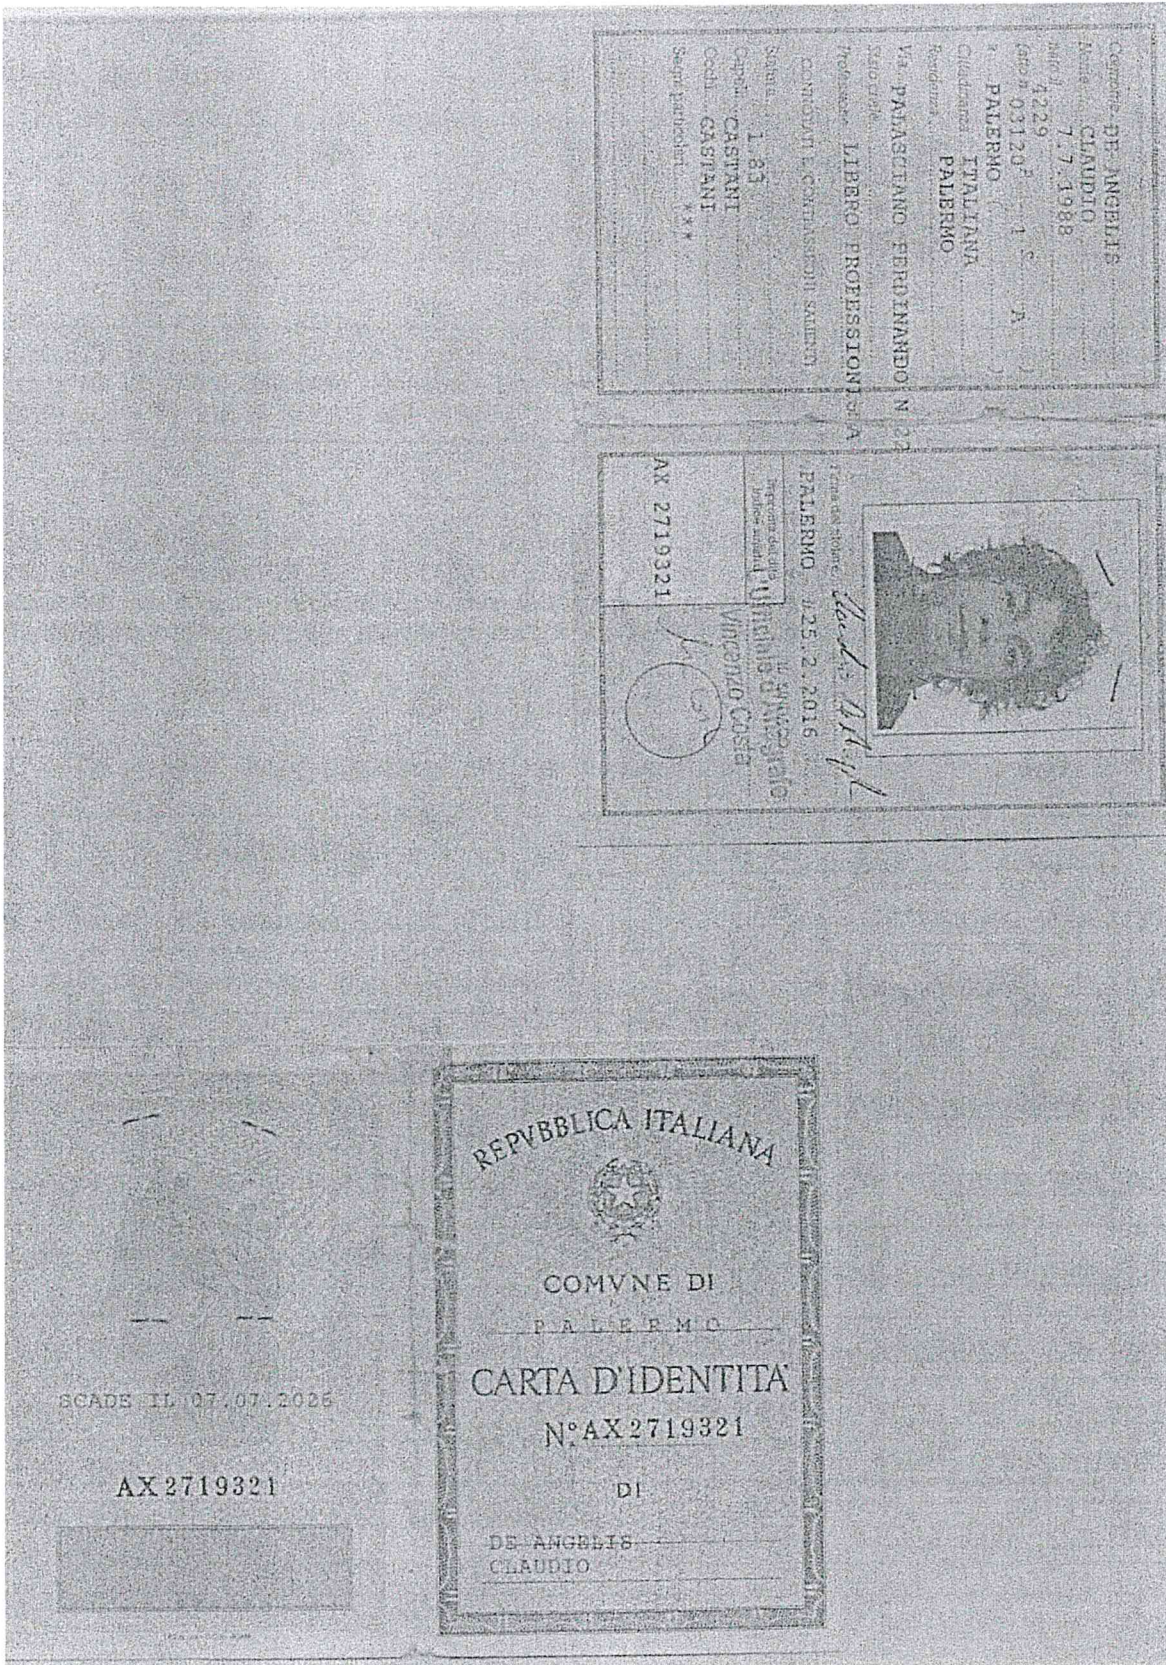


Dea MEDICAL

HEALTH CARE SOLUTION

Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Neonati 500g < >1200g (Cf 20 pz)	WMCP-5410A	<u>CND M0599 - RdM 1622262</u>
Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Infanti 1200g < >2500g (Cf 20 pz)	WMCP-5500A	<u>CND M0599 - RdM 1622265</u>
Septal-H™, adesivo di fissaggio e protezione Mis Pediatriche ≥ 2500g (Cf 20 pz)	WMCP-5510A	<u>CND M0599 - RdM 1622267</u>
Cerotti di fissaggio Mis S (Cf 10 Pz)	MJ1380	<u>CND M0599 - RdM 1804606</u>
Cerotti di fissaggio Mis L (Cf 10 Pz)	MJ1381	<u>CND M0599 - RdM 1804607</u>
Tortle Midliner, per generatori nCPAP - oro (Cf 10 pz)	TT65911-FP	<u>CND V0299 - RdM 1776594</u>
Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde scuro (Cf 10 pz)	TT65901-FP	<u>CND V0299 - RdM 1776623</u>
Tortle Midliner, per generatori nCPAP - verde chiaro (Cf 10 pz)	TT65903-FP	<u>CND V0299 - RdM 1776662</u>
Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia XS (Cf 10 pz)	BBNS-CS000	<u>CND R03010203 RdM 1793646</u>
Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia S (Cf 10 pz)	BBNS-CS001	<u>CND R03010203 RdM 1793650</u>
Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia M (Cf 10 pz)	BBNS-CS002	<u>CND R03010203 RdM 1793663</u>
Nasocannule NeoSmart™ con cerotti di fissaggio Comfort Sleeve, monouso - Taglia L (Cf 10 pz)	BBNS-CS003	<u>CND R03010203 RdM 1793666</u>
Circuito paziente con raccordo a T universale, monouso (Cf 10 pz)	MF10-50900	<u>CND Z12159099 - RdM 1372839</u>
Neo-Tee™ rianimatore neonatale (0-60 cmH2O) con unità di controllo in linea e "Override (Cf 10 pz)	MF10-50822	<u>CND Z12159099 - RdM 1373031</u>
Cavo sonde di temperatura	BBHY9500-100NS	<u>CLASSE I - Non soggetto a registrazione</u>
Cavo di riscaldamento doppio	BBHY9500-102NS	<u>CLASSE I - Non soggetto a registrazione</u>

DEA MEDICAL Srl

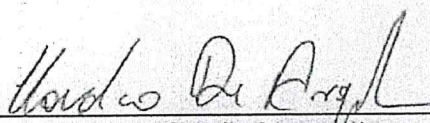
 (Claudio De Angelis)

Nome: DE ANGELO CLAUDIO
Data di nascita: 7.7.1988
Codice fiscale: 4229
Città: PALERMO
Categoria: ITALIANA
Paese: PALERMO
Professione: PALAESTRANO FERDINANDO N.2
Indirizzo: LIBERO PROFESSIONISTA A
Categoria: CORRIGIAMO E CONTINUIAMO SALENTI
Scadenza: 1.83
Cognome: CASTELLI
Codice: CASTELLI
Segno particolare: ***

Traccia del titolare:
PALERMO, 22.2.2016

INCARICATO PER LA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
VINCENZO COSÌ
AX 2719321

SCADDE IL 07/07/2026
AX 2719321

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALERMO
CARTA D'IDENTITÀ
N° AX 2719321
DI
DE ANGELO CLAUDIO

Assago (Mi), 19 settembre 2019

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE - CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI**Piazza Nicola Leotta n. 4
90127 PALERMOe p.c. **DEA MEDICAL SRL**Via Edmondo De Amicis, 28
90143 Palermo (PA)
C.A. Egr. Sig. Claudio De Angelis**OGGETTO: Vs. Prot. n. 2461 dell'11/09/2019 – Indagine di mercato per "La fornitura annuale di materiale dedicato al sistema di raffreddamento neonatale Tecotherm e materiale per CPAP in uso presso l'U.O.C. di Neonatologia-Ufin del P.O. Civico"****DICHIARAZIONE ELENCO PRINCIPALI FORNITURE**

Il sottoscritto Giusto Bonandrini, nato a Dovera (CR) il 7.10.1955 e residente a Lodi (LO) (Cap 26900) in Corso Roma n. 124, Codice Fiscale BNNGST55R07D358R, in qualità di Amministratore Delegato/Presidente C.d.A. – RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA – SOCIO AZIONARIO AL 50% (TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA' di n. 19.125 azioni) della società "Burke & Burke S.p.A." avente sede legale ad Assago (Mi), Via A. Einstein n. 32, Codice Fiscale 02737030151 e Partita IVA 01059590107, con la presente offerta,

DICHIARA

In qualità di ditta importatrice e distributrice esclusivista su tutto il territorio nazionale dei prodotti oggetto della presente indagine di mercato,

- che l'elenco delle principali forniture identiche ai prodotti oggetto della presente indagine, effettuate ad altre strutture sanitarie con l'indicazione di data, nome del committente, importo contabilizzato, quantità, è il seguente:

codice BBHY9500-100NS

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato €
ESTAR - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale	003630/18P	12/12/2018	1	418,00
Elettronica Bio Medica SPA di Perugia	001356/18D	28/06/2018	2	880,00

codice BBHY9500-102NS

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna	001649/18P	11/06/2018	2	522,00

codice MF10-50822

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
ASST BERGAMO EST	002238/17P	31/08/2017	1	320,00
ASST BERGAMO EST	002219/18P	31/07/2018	1	320,00

codice WMCP-5410A

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	001616/18D	31/07/2018	1	281,70
Azienda Ospedaliera di Perugia	001937/18P	06/07/2018	1	281,70

codice IHTC-CDT

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
Ospedale Generale Valduce di Como	000019/18D	16/01/2018	1	60,00
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria	001195/18P	19/04/2018	1	60,00

codice IHTC-FFL

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
OSPEDALE BUON CONSIGLIO - NA FATEBENEFRAPELLI	001051/17D	16/05/2017	1	161,50

codice IHTC-FMT400/AEC-P

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
Az. Osp. Rilievo Naz. e alta Specializzazione CIVICO-DI CRISTINA-BENEFRAPELLI	000724/18P	08/03/2018	1	45,00

codice IHTC-FMT400/AS-THT

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
Az. Prov. per i Servizi sanit. della Prov. autonoma di Trento	002855/17P	31/10/2017	1	820,00
Azienda Ospedaliera OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE BARI	002284/18P	02/08/2018	1	820,00
Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	001087/17P	20/04/2017	2	1.640,00

codice IHTC-FMT400/POR

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
Az. Prov. per i Servizi sanit. della Prov. autonoma di Trento	002856/17P	31/10/2017	1	520,00
Tecnologie Sanitarie S.P.A. Roma	001758/17D	31/08/2017	1	520,00
Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	001087/17P	20/04/2017	2	1.040,00

codice IHTC-MATT-NEO

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
Azienda Sanitaria Locale TA	003290/17P	12/12/2017	1	909,00

codice NAOBM00042

Ragione sociale	NrDoc	DtaDoc	Quantità	Netto Fatturato
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	001657/18P	11/06/2018	1	504,00

In fede.


BURKE & BURKE S.p.A.
Giusto Bonandrini
Amministratore Delegato/Presidente CDA

All.f.i: copia C.I. del sottoscrittore n. ITA CA53911EW9, scadenza 07/10/2029



**Unità Operativa Complessa
Neonatologia – TIN – Nido**

Direttore: *S. Marcello Vitaliti*

1-11-11 F11

Prot. 121 /TIN/2019

Palermo li, 5 dicembre 2019

001078

Area Provveditorato

Preg.mo Ing. *V. Spera*

Oggetto: acquisto, urgente, materiale dedicato alle apparecchiature Burke & Burke in dotazione e in uso presso codesta UOC di TIN e Neonatologia.

Al fine di potere continuare a fornire assistenza ai pazienti degenti presso codesta UOC e nel contempo potere utilizzare le apparecchiature in dotazione a codesta UOC della ditta Burke & Burke è indispensabile l'acquisto del materiale di consumo sotto riportato. Si precisa che, al fine di non avere una pericolosa discontinuità nella presenza di tale materiale sarebbe auspicabile che la fornitura venisse garantita almeno per anni tre (3) e in tal senso si riportano i fabbisogni, presunti, per tale intervallo di tempo.

Ausplicando ad un positivo e rapido riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il direttore UOC

S. M. Vitaliti



**Unità Operativa Complessa
Neonatologia – TIN – Nido**

Direttore: *S. Marcello Vitaliti*

Prot. 121 /TIN/2019

Palermo li, 5 dicembre 2019

FABBISOGNO MATERIALE BURKE & BURKE PER LA DURATA DI ANNI TRE (3)

MATERIALE SISTEMA RAFFREDDAMENTO TECOTHERM

N° confezioni	Descrizione	Codice
15	Copertine , monouso, per materassino (Confezione da 10 pz.)	IHTC-FFL
6	Materassino avvolgente Aqua Wrap (Confezione da 10 pz)	IHTC-MATT-NEO
6	Cavo adattatore Sensore Temperatura Rettale	IHTC-FMT400/AEC-P
6	Sensore temperatura rettale (riutilizzabile)	IHTC-FMT400/POR
6	Sensore temperatura cutanea (riutilizzabile)	IHTC-FMT400/AS-THT
6	Sensore temperatura rettale, monopaziente (Confezione da 10 pz)	IHTC-FMT400/AOR-D/1
6	Elettrodi in Hydrogel per OBM (Confezione 60 pz)	NAOBM00042
12	Elettrodi ad ago per OBM (Confezione 24 pz)	NAOBM00046
3	Pastiglie di diossido di Cloro (Confezione 30 pz)	IHTC-CDT
30	Sensore SenSmart Equanox Neo (confezione 20 pz)	NN9750-001

MATERIALE PER CPAP

N° confezioni	Descrizione	Codice
120	Hydrocolloide Septal H <500 g (Confezione 20 pz)	WMCP-5400A
120	Hydrocolloide Septal H 500 – 1,2 Kg (Confezione 20 pz)	WMCP-5410A
120	Hydrocolloide Septal H 1,2 e 2,5 Kg (Confezione 20 pz)	WMCP-5500A
120	Hydrocolloide Septal H > 2,5 Kg (Confezione 20 pz)	WMCP-5510A
120	Cerotti guanciali in Hydrocolloide Mis. S (confezione 20 pz)	MJ1380
120	Cerotti guanciali in Hydrocolloide Mis. M (confezione 20 pz)	MJ1381
120	Tortle Midliner Diam 17-22 cm (confezione da 10 pz)	TT65911-FP



**Unità Operativa Complessa
Neonatologia – TIN – Nido**

Direttore: *S. Marcello Vitaliti*

001078

N° confezioni	Descrizione	Codice
90	Tortle Midliner Diam 22 - 30 cm (confezione da 10 pz)	TT65901-FP
90	Tortle Midliner Diam 30 – 38 cm (confezione da 10 pz)	TT65903-FP
60	NeoSmart XS <750 g (confezione d 10 pz)	BBNS-CS000
90	NeoSmart S 750 g – 1,5kg (confezione d 10 pz)	BBNS-CS001
90	NeoSmart M 1,5 – 2,5 kg (confezione d 10 pz)	BBNS-CS002
90	NeoSmart L, > 2,5kg (confezione d 10 pz)	BBNS-CS003
210	Circuito per T-Piece (confezione 10 pz)	10-50900
210	Circuito Neo-Tee per Rianimazione (confezione 10 pz)	MF10-50822
48	Cavo sonde temperatura Hydraltis (confezione 1 pz)	BBHY9500-100NS
48	Cavo riscaldamento doppio Hydraltis (confezione 1 pz)	BBHY9500-102NS

Il direttore UOC

S. M. Vitaliti

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 22 DIC. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
